

DECISION D'APPROBATION DE MODELE  
N° 92.00.612.008.1 DU 18 DECEMBRE 1992

**Système de balances  
à équilibre automatique TESTUT  
modèle 907  
à indication du poids et du prix  
(CLASSE III)**

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET N° 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DU DECRET N° 65-487 DU 18 JUIN 1965 MODIFIE PAR LE DECRET N° 75-1201 DU 4 DECEMBRE 1975 REGLEMENTANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE ET INSTRUMENTS DE PESAGE INDIQUANT LE PRIX.

**FABRICANT**

Société TESTUT, 855, rue de l'Horlogerie, BP 11, 62401 Béthune.

**CARACTERISTIQUES**

Le système de balances TESTUT, modèle 907, est composé de balances TESTUT, modèles J917 ou J957, ayant fait l'objet de la décision d'approbation de modèles n° 92.00.611.043.1 du 18 décembre 1992 (1), ou J617, faisant l'objet des décisions n° 91.00.611.033.1 du 24 décembre 1991 (2) et n° 92.00.611.040.1 du 8 décembre 1992 (3), ou J757 faisant l'objet de la décision n° 91.00.611.020.1 du 15 juillet 1991 (4).

10 balances au plus peuvent être connectées dans le même système. L'une de ces balances est désignée comme maître par l'adjonction d'un boîtier connecté sur sa sortie série.

(1) *Revue de Métrologie*, décembre 1992, page 1824.

(2) *Revue de Métrologie*, décembre 1991, page 1397.

(3) *Revue de Métrologie*, décembre 1992, page 1813.

(4) *Revue de Métrologie*, août 1991, page 823.

Les enregistrements peuvent se faire sur n'importe quelle balance du système et sont mémorisés dans la balance maître.

Les balances sont identifiées par un numéro d'unité dans le système, compris entre 0 et 9, et programmable sur chaque balance.

**INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES**

Chaque balance du système porte sur sa plaque d'identification le numéro et la date d'approbation prévus dans la décision précitée qui la concerne.

Chaque balance porte de plus à proximité de la plaque d'identification, une étiquette auto-adhésive portant le numéro et la date de la présente décision.

**DEPOT DE MODELE**

Plans et schémas déposés à la sous-direction de la métrologie, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du Nord-Pas-de-Calais et chez le fabricant.

**REMARQUE**

Le système de balance TESTUT modèle 907 objet de la présente décision peut être commercialisé.



sé sous les marques TESTUT, LEONARD ou sous d'autres marques.

**VALIDITE**


La présente décision a une durée de validité de dix ans à compter de la date figurant dans son titre.

**ANNEXES**

Notice descriptive.

Modèle d'étiquette auto-adhésive n° 5854.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :  
PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE  
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,  
L'INGENIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE,  
J. HUGOUNET

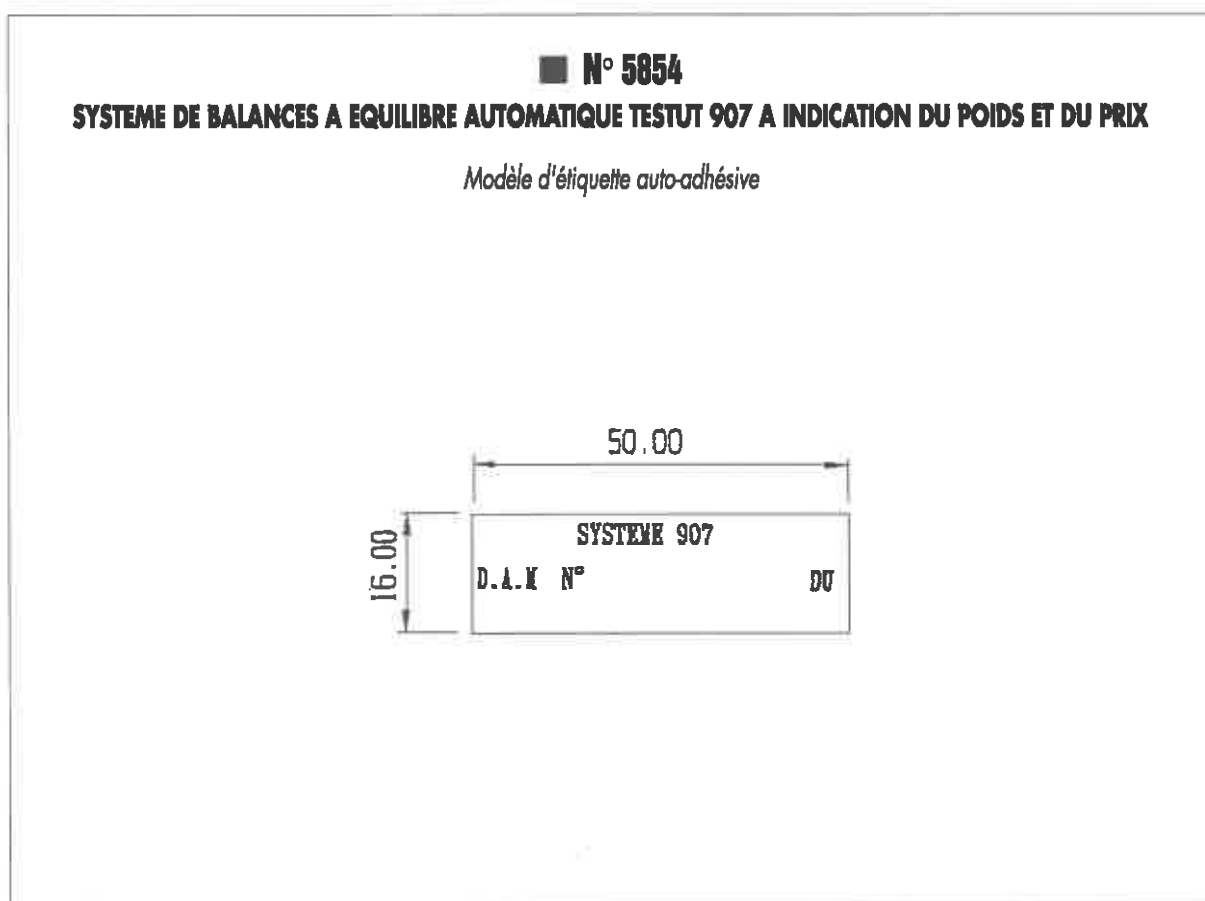

NOTICE DESCRIPTIVE

Système de balances  
à équilibre automatique TESTUT  
modèle 907  
à indication du poids et du prix

**2 MODES DE FONCTIONNEMENT  
LIES A L'INTERCONNEXION**

5 modes de fonctionnement sont prévus selon le choix fait par la programmation de la balance :

**1) Mode isolé**

Option MODE ISOLE = OUI

**a) 1 seul vendeur**

Option ISOLE/VENDEUR = NON

On imprime au fur et à mesure les enregistrements comme une balance à un seul vendeur

**b) Plusieurs vendeurs**

Option ISOLE/VENDEUR = OUI

La balance est une multi-vendeurs, il faut introduire le numéro de vendeur pour chaque enregistrement.

**2) Mode interconnecté**

Option MODE ISOLE = NON

**a) 1 seul vendeur**

Paramètre 'VEND\_UNIQU' non nul  
Option CLIENT = NON

Un seul vendeur peut se servir de la balance, c'est celui dont le numéro figure dans le paramètre 'VEND\_UNIQU'

**b) Plusieurs vendeurs**

Paramètre 'VEND\_UNIQU' = 0  
Option CLIENT = NON

Il faut introduire le numéro de vendeur pour chaque enregistrement.

**c) Mode CLIENT**

Paramètre 'VEND\_UNIQU' = 0  
Option CLIENT = OUI

Chaque client est repéré par une méthode quelconque, panier numéroté de 1 à 99, badge, etc.

Le client se présente à chaque poste de pesée, le vendeur tabule chaque fois le numéro du client.